




value deviation from reference - temperature

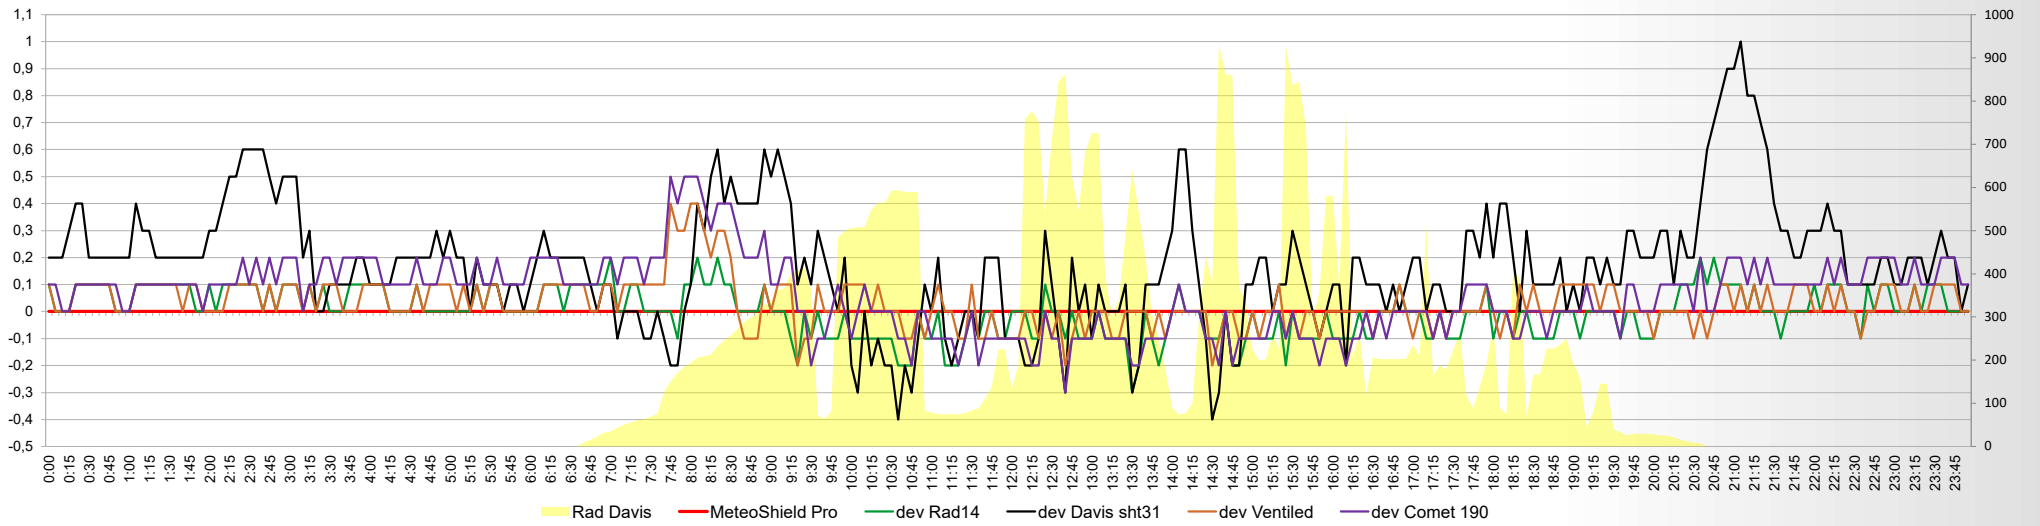


Wind m/s

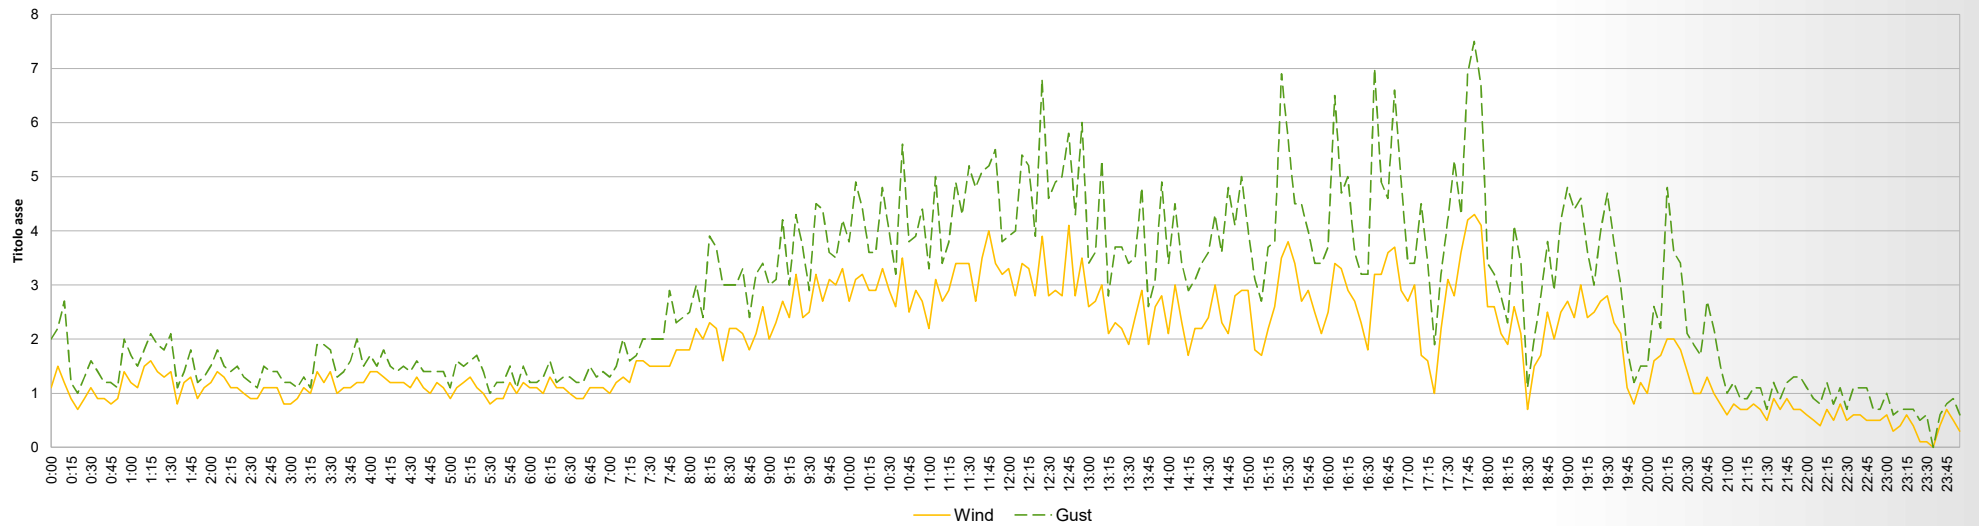

Temperature and Solar rad

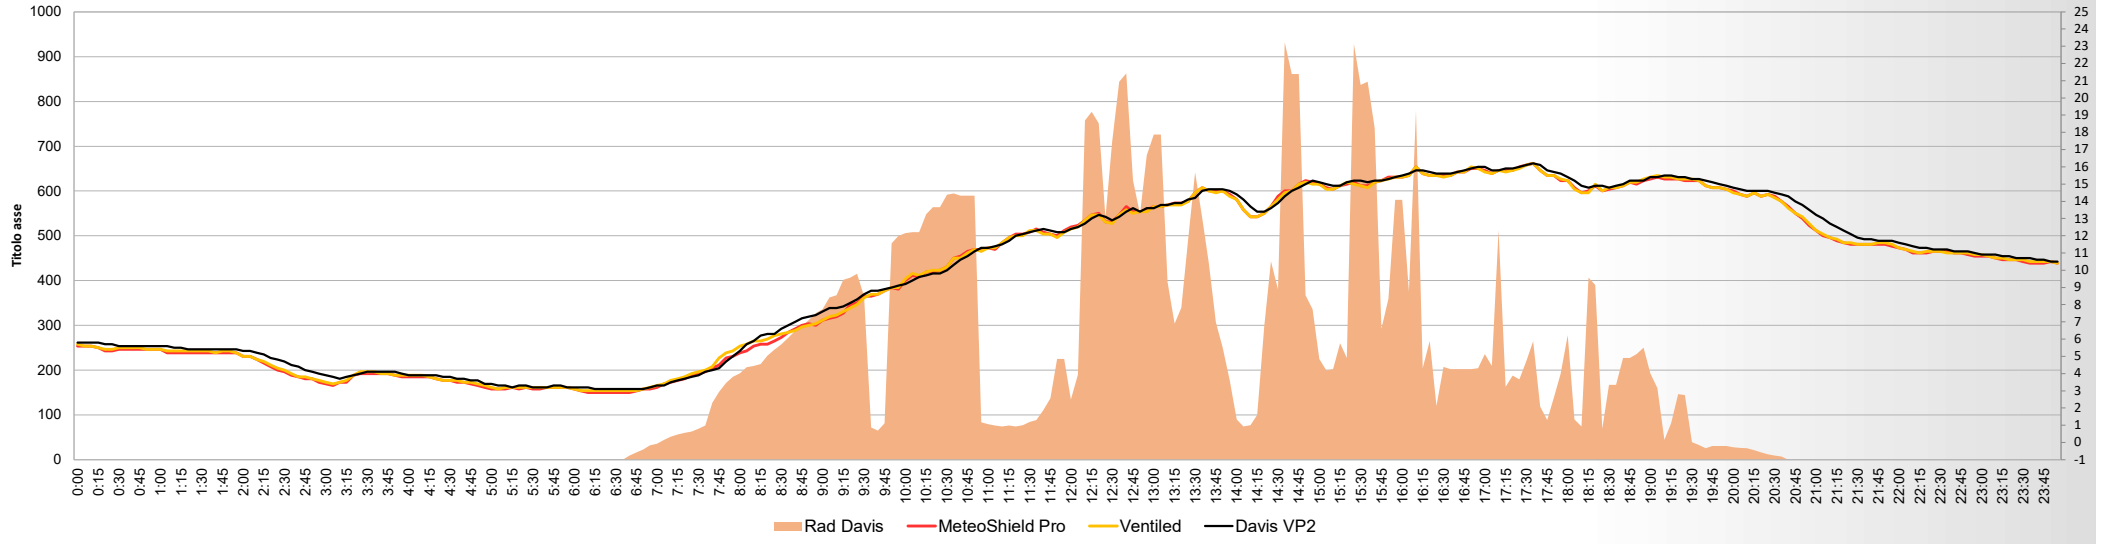


Reference deviation frequency (MeteoshieldPro3)

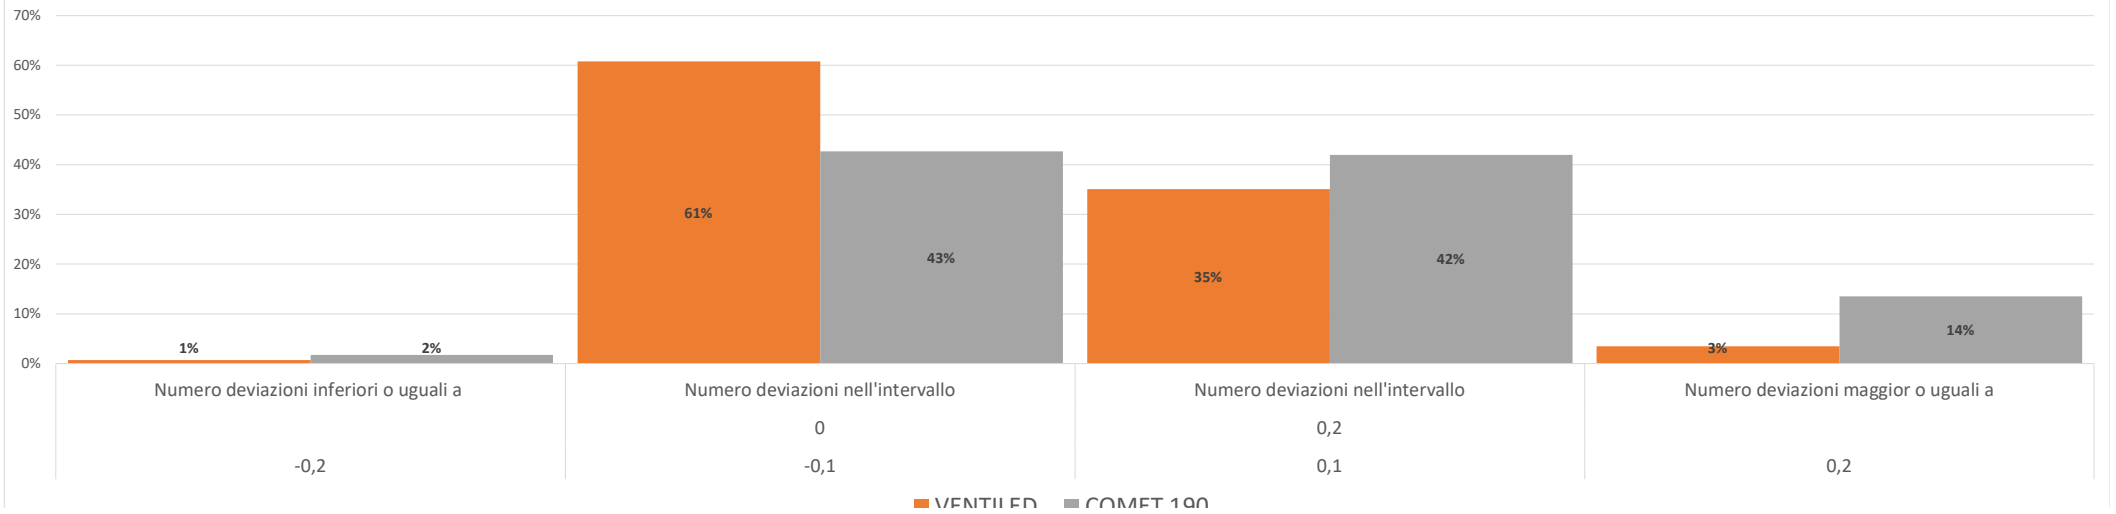

VENTILED COMET 190

reference deviation frequency (MeteoshieldPro3)

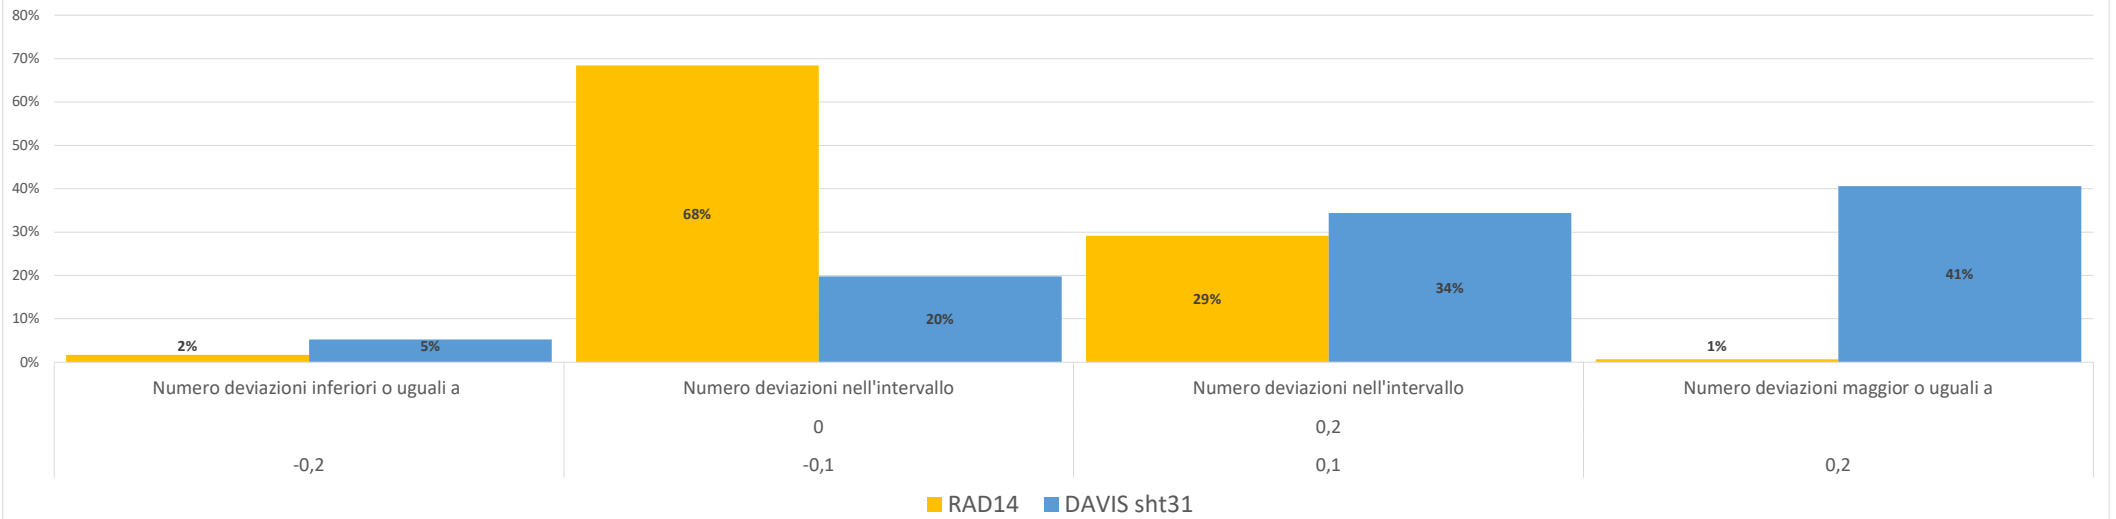

Summary

Antonio FR

21/04/23

SGZ - France

Temperature	Min	Max	Avg	Dev	00-06	06-12	12-18	18-24
Meteoshield	2,9	16,2	9,75					
Rad14	2,9	16,1	9,75	-0,00	0,05	-0,01	-0,06	0,02
Davis sht31	3,1	16,2	9,92	0,17	0,24	0,10	0,07	0,28
Ventiled	3	16,2	9,78	0,03	0,06	0,06	-0,03	0,03
COMET 190mm	3	16,2	9,80	0,06	0,12	0,10	-0,07	0,08

CONFRONTO SCHERMI

Fascia Oraria	METPRO	COMET 190	DAVIS sht31	VENTILED	RAD14	Vento	Radiazione solare
0-1	5,43	0,07	0,24	0,05	0,05	1,03	0,00
1-2	5,18	0,09	0,24	0,07	0,08	1,23	0,00
2-3	4,09	0,14	0,50	0,07	0,08	1,05	0,00
3-4	3,81	0,16	0,16	0,06	0,06	1,17	0,00
4-5	3,53	0,13	0,19	0,06	0,03	1,17	0,00
5-6	3,15	0,13	0,10	0,03	0,03	1,07	0,00
6-7	2,98	0,15	0,17	0,08	0,09	1,06	9,58
7-8	4,18	0,28	-0,06	0,18	0,02	1,53	103,83
18-19	14,87	-0,02	0,17	0,03	-0,04	2,08	208,00
19-20	15,06	0,02	0,18	0,03	-0,04	2,03	65,83
20-21	13,76	0,10	0,48	-0,00	0,09	1,35	9,67
21-22	11,58	0,13	0,49	0,05	0,02	0,73	0,00
22-23	11,00	0,16	0,19	0,03	0,04	0,56	0,00
23-24	10,54	0,14	0,16	0,05	0,04	0,35	0,00
SCOSTAMENTO MEDIO	7,79	0,12	0,23	0,06	0,04		
MEDIA	9,76	9,82	9,92	9,79	9,75	1,84	169,44
MIN	2,90	3,00	3,10	3,00	2,90	0,00	0,00
MAX	16,20	16,20	16,20	16,20	16,10	4,30	932,00

Variance shields by time slot

